

## Forschungsinstitut für Resonanzphänomene

**Olaf Baumunk -- Bioplasmatiker**

Schwand 9 --- D 79837 Häusern

Tel: 0176 - 42640640 -- E-Mail: baumunk52@aol.de

**Aschoff Reiz-Test: BioRing von SWISS HARMONY**

16.04.2016




**Der Aschoff Reiz-Test hat ein Bundes-Patent und ist anerkannt.** Beim Aschoff Reiz-Test wird an den 10 Tingpunkten der linken Hand der Hautwiderstand gemessen. Je höher der Hautwiderstandswert ist, desto schlechter ist der bioenergetische Zustand eines Menschen.

Der Normalwert eines gesunden Menschen beträgt im Idealfall 40 Kilo Ohm. Dieser ideale Ausgangswert wird aber selten erreicht. Es wird meistens ein Ausgangswert von 60 – 70 KO gemessen. MP 1 – 10 sind die Messpunkte der Finger.

Die erste Messung wird **ohne Belastung** gemacht. (blaue Linie)

Die zweite Messung wird **unter Belastung aber ohne BioRing** gemacht. (rote Linie)

Die dritte Messung wird **unter Belastung und mit BioRing** gemacht. (graue Linie)

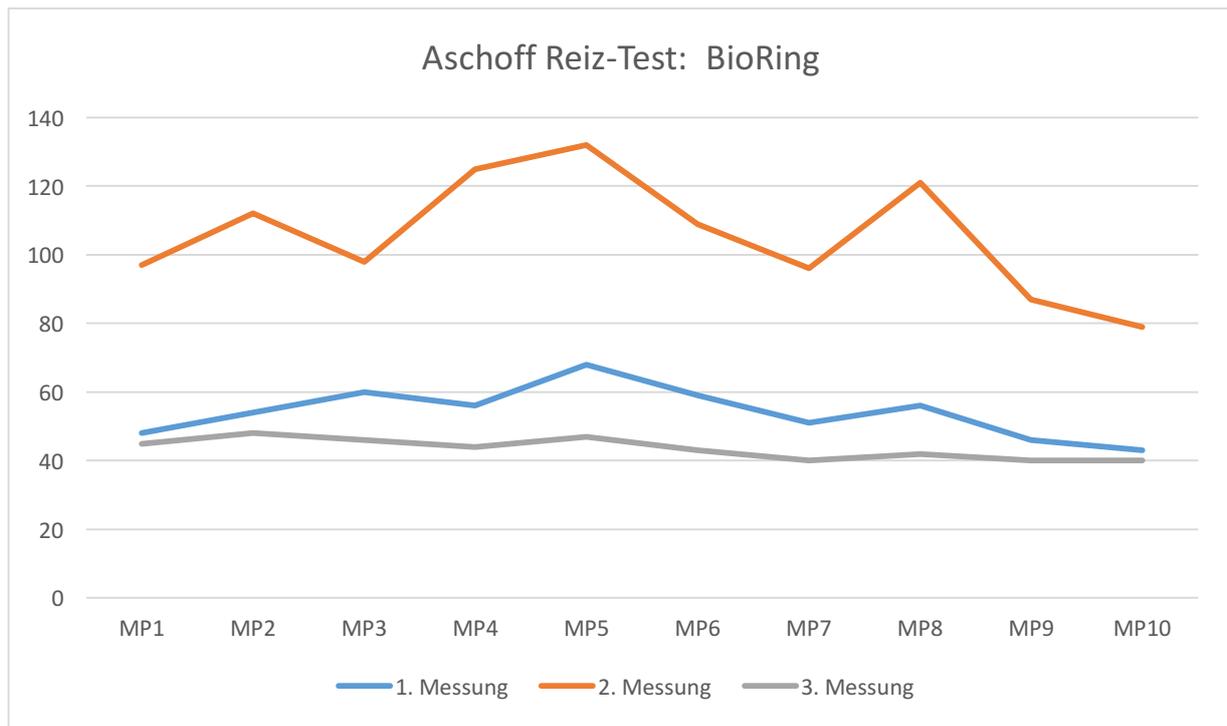

### Ergebnis:

Die erste Messung zeigt eine geringfügig erhöhte Abweichung der Messwerte vom Normalwert von 40 Kilo Ohm. Das mag daran liegen, dass die Testperson seit dem Test der Body Card vom Vortag die Body Card dauernd bei sich trug, wodurch sich die Messwerte auf ein mehr normales Niveau eingependelt haben. Die Tatsache, dass die Body Card 3 Stunden vor diesem Test des BioRing abgelegt wurde, zeigt, dass das Energiefeld der Testperson auch noch 3 Stunden nach Ablegen der Body Card recht stabil blieb, was auf eine Gesamtstabilisierung des bioenergetischen Zustandes der Testperson schließen lässt.

Bei der zweiten Messung wird die Testperson unter erhebliche elektromagnetische Belastung gestellt indem eine Verbindung zwischen zwei Mobiltelefonen hergestellt wird, zwischen denen sich die Testperson beim Test befindet. Zusätzlich wird ein unter Strom stehendes Verbindungskabel (1800 Watt) einer eingeschalteten Elektroheizung um ein Bein der Testperson gelegt. Die rote Linie im Diagramm zeigt eine deutliche Erhöhung des Hautwiderstandswertes unter der vorgenommenen Belastung durch hochfrequente und niederfrequente elektromagnetische Felder.

### **Hochgradig gesundheitsschädlich!**

Die Messwerte der 3. Messung (graue Linie im Diagramm) unter Belastung aber mit BioRing am Finger der Testperson sind auffallend niedrig und entsprechen fast dem Normalwert von 40 Kilo Ohm. **Schlussfolgerung:** Die dauerhafte Anwendung der Produkte von SWISS HARMONY bringt eine Gesamtstabilisierung des bioenergetischen Zustandes des Anwenders mit sich.

**Der BioRing von SWISS HARMONY erzeugt ein gesundes Energiefeld, dass den schädlichen Einfluss von elektromagnetischen Energiefeldern (E-Smog) und anderen pathogenen Feldern völlig neutralisiert. Bioenergetisch sehr wertvoll.**