

Forschungsinstitut für Resonanzphänomene

Olaf Baumunk -- Bioplasmatiker

Schwand 9 --- D 79837 Häusern

Tel: 0176 - 42640640 -- E-Mail: baumunk52@aol.de

Aschoff Reiz-Test: BioPendant von SWISS HARMONY

18.04.2016




Der Aschoff Reiz-Test hat ein Bundes-Patent und ist anerkannt. Beim Aschoff Reiz-Test wird an den 10 Tingpunkten der linken Hand der Hautwiderstand gemessen. Je höher der Hautwiderstandswert ist, desto schlechter ist der bioenergetische Zustand eines Menschen.

Der Normalwert eines gesunden Menschen beträgt im Idealfall 40 Kilo Ohm. Dieser ideale Ausgangswert wird aber selten erreicht. Es wird meistens ein Ausgangswert von 60 – 70 KO gemessen, was man im Diagramm sehen kann. MP 1 – 10 sind die Messpunkte der Finger.

Die erste Messung wird **ohne Belastung** gemacht. (blaue Linie)

Die zweite Messung wird **unter Belastung aber ohne BioPendant** gemacht. (rote Linie)

Die dritte Messung wird **unter Belastung und BioPendant** gemacht. (graue Linie)

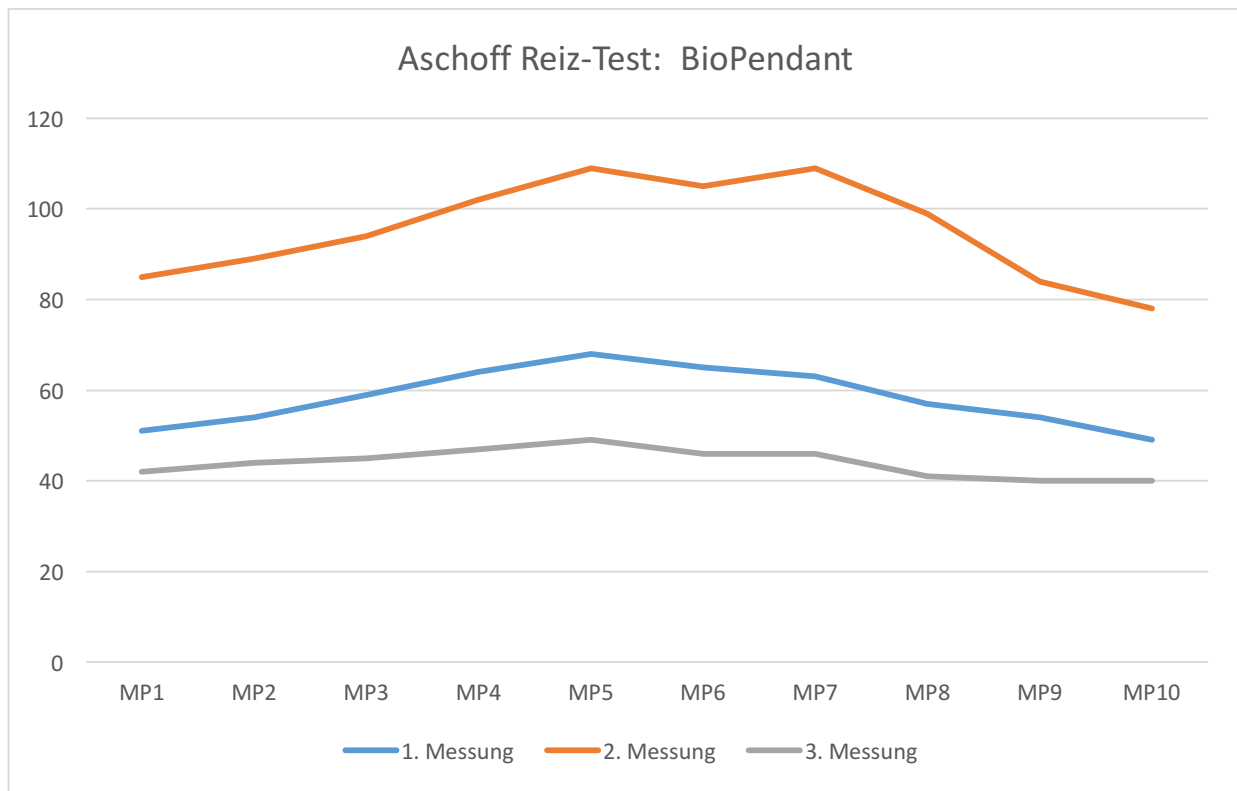

Ergebnis:

Die erste Messung (blaue Linie im Diagramm) zeigt an, dass die Testperson (männlich, 64 Jahre alt) zwar unter Belastung von pathogenem Umwelteinfluss steht, aber akzeptable Werte hat, die keinen Anlass zu Sorge geben. Der Idealwert (40 KO) ist nur leicht überschritten.

Bei der zweiten Messung wird die Testperson unter erhebliche elektromagnetische Belastung gestellt, indem eine Verbindung zwischen zwei Mobiltelefonen hergestellt wird, zwischen denen sich die Testperson beim Test befindet. Zusätzlich wird ein unter Strom stehendes Verbindungskabel (1800 Watt) einer eingeschalteten Elektroheizung um ein Bein der Testperson gelegt. Die rote Linie im Diagramm zeigt eine deutliche Erhöhung des Hautwiderstandswertes unter der vorgenommenen Belastung durch hochfrequente und niederfrequente elektromagnetische Felder.

Hochgradig gesundheitsschädlich!

Die Messwerte der 3. Messung (graue Linie im Diagramm) unter Belastung aber mit BioPendant am Hals hängend sind überraschend gut. Sie sind unter den Werten der ersten Messung ohne Belastung und ohne BioPendant und erreichen fast den Idealwert. Dies lässt nur einen Rückschluss zu:

Der BioPendant von SWISS HARMONY erzeugt ein gesundes Energiefeld, das den schädlichen Einfluss von pathogenen Energiefeldern inkl. (E-Smog) völlig neutralisiert. Bioenergetisch sehr wertvoll.